

Прибор для определения холодной слеживаемости асфальта № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

С какого числа и месяца работает \_\_\_\_\_

Какие недостатки и когда Вы заметили во время работы с прибором \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ваши замечания по точности, надежности и внешней отделке штатива \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ваш адрес, название предприятия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность составителя листка отзыва \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ваш отзыв поможет нам улучшить качество продукции.

**Прибор для определения холодной слеживаемости  
асфальта ПС-01**

ПАСПОРТ

LAB-OBORUDOVANIE.RU

г. Челябинск  
2019 г.

### 1. Назначение.

**Прибор для определения холодной слеживаемости асфальта ПС-01** предназначен для работы в соответствии с ГОСТ 12801-98. Сущность метода заключается в оценке способности холодной смеси не слеживаться при хранении в штабеле.

### 2. Комплектность.

2.1. Прибор ПС-01 в сборе - 1 шт.

2.2. Паспорт. - 1 шт.

Прибор ПС-01 (рисунок 1) состоит из основания с подставкой 1 для образца 2, с отверстием 3, штанги 6 и направляющей втулки 8. Во втулке свободно перемещается штанга с навинченным на нее конусным наконечником 4.


Масса штанги с наконечником —  $(500 \pm 5)$  г. Угол в вершине конуса —  $(15,0 \pm 0,5)^\circ$ . По штанге свободно перемещается цилиндрический груз 5 массой  $(500 \pm 5)$  г. Высота подъема груза на штанге ограничена сверху упорным кольцом 7 и составляет  $(200 \pm 2)$  мм. В центре основания имеется отверстие для предохранения острия конуса от затупления. Для фиксации момента касания острия конуса нижней подставки в верхней части штанги нанесена риска 9.

### 3. Порядок подготовки к проведению испытания

Для испытания готовят три образца в соответствии с 6.1.5. ГОСТа 12801-98. Перед испытанием образцы выдерживают в воздушной среде при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  не менее 4 ч.

Образец устанавливают на основание, а острие конуса, осторожно направляя рукой, вводят в отверстие образца. Груз поднимают до упорного кольца и опускают его. Удары груза по конусу повторяют до полного разрушения образца или до тех пор, пока острие конуса коснется подставки. При испытании необходимо следить за тем, чтобы при поднятии груза острие конуса не выходило вверх из отверстия в образце.

Рисунок 1 — Прибор ПС-01

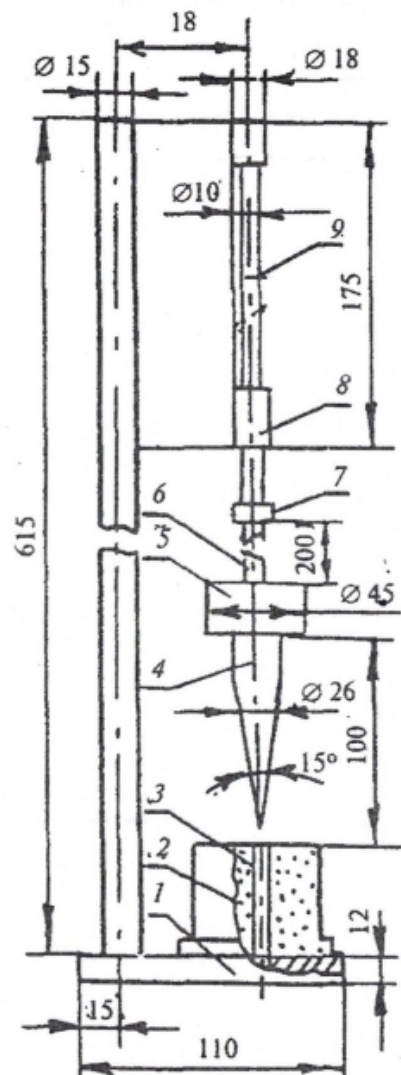

#### 4. Обработка результатов испытания

За условный показатель слеживаемости холодной смеси принимают количество ударов, необходимое для полного разрушения образца конусом.

Показатель слеживаемости вычисляют как среднеарифметическое результатов испытания трех образцов. Расхождение между наибольшим и наименьшим результатами испытаний не должно быть более четырех ударов.

#### 5. Свидетельство о приемке.

Прибор для определения холодной слеживаемости асфальта ПС-01, заводской № 11 в количестве 1 шт. соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 27.08.2019

Подпись лиц ответственных за приемку

Дата продажи 30.08.2019

Штамп предприятия-продавца

Подпись продавца

*[Handwritten signature]*

#### 6. Гарантии.

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи.