

ФГУП «ВНИИМС»

наименование исполнительного органа РСК

наименование юридического лица

454000, Челябинск, ул. Ак. Королева, д. 40, офис 3

юридический адрес

Свидетельство №001380 действительно до 6 августа 2019 г.

номер и срок действия Свидетельства о регистрации в РСК




СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ №12630

- I. Наименование, тип, заводской номер СИ Объемомер для определения объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси (10л), зав. №39
- II. Дата поступления на калибровку 28.05.2018
- III. Наименование и адрес заказчика _____
- IV. Место проведения калибровки Челябинск, ул. Ак. Королева, д. 40, оф. 3
- V. Дата проведения калибровки 28.05.2018
- VI. Методика калибровки (наименование, номер, кем утверждена) МК 20-07.
- VII. Условия проведения калибровки: Температура 21°C, влажность 50%, освещенность 400 лк.
- VIII. Доказательства прослеживаемости измерений (сведения об используемых при калибровке эталонах, №№ и даты св-в о поверке: Пипетка 10мл (пов.клеймо 2кв.2014г), Колба мерная (пов.клеймо 3кв.2008г), Микроскоп-твердомер МВП-1 (№ЧБ.К.5516-17 от 24.07.2017г), Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 (пов.клеймо 24.07.17г.), Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 (пов.клеймо 16.01.18г), Штанглубиномер ШГ-400 (пов.клеймо 12.02.16г), Плита поверочная 400x400 мм (пов.клеймо 4кв.17г), Штанглубиномер ШГ-400 (пов.клеймо 16.01.18г)

На основании результатов первичной калибровки, протокол №9193 от 28.05.2018, установлено, что указанное средство измерений соответствует требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ 10181.3) и допускается к применению.

Калибровку выполнил
/Костян М.И./

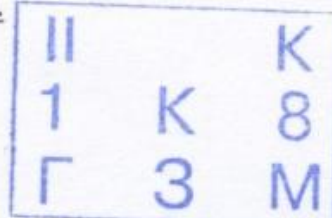

Рекомендуемая дата следующей калибровки 28.05.2019

IX. Результаты калибровки (основные параметры)

№	Параметр	Единица измерения	Номинальный размер	Допуск	Фактический размер
1	Диаметр	мм	234,00	±3,00	Соответствует
2	Высота	мм	232,60	±3,00	Соответствует
3	Объем	мм	10000,00	±150,00	Соответствует
4	Длина стрелки	мм	22,00	±0,40	Соответствует
5	Пуансон с металлической сеткой с размерами ячеек 1,2мм	мм	1,20	±0,04	Соответствует

LAB-OBORUDOVANIE.RU

К
8
М

Х
8
8

И
1
7