

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт  
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный  
ОБН-150-«КРОНТ»

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Штамп предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_  
подпись

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
название организации (полностью)  
\_\_\_\_\_ индекс, город, область/район, улица, дом, строение, телефон  
\_\_\_\_\_

Характер неисправности \_\_\_\_\_  
заполняется лицом, ответственным за техническое обслуживание  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Контактное лицо, ответственное за техническое обслуживание: \_\_\_\_\_  
ФИО, телефон, e-mail

Дата возникновения неисправности \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Выполнена работа по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Штамп предприятия

ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ  
БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ  
ОБН-150-«КРОНТ»  
в исполнениях

**ОБН-150-1-(2x30)-«КРОНТ»**

**ОБН-150-1-(2x55)-«КРОНТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КРПФ.941712.1700 РЭ



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Назначение изделия	3
2. Технические характеристики	4
3. Комплектность	6
4. Указания по технике безопасности	6
5. Устройство и принцип работы	7
6. Подготовка и порядок работы	8
7. Техническое обслуживание	9
8. Возможные неисправности и методы их исправления	10
9. Утилизация	12
10. Правила транспортирования и хранения	12
11. Свидетельство о приемке	13
12. Гарантии изготовителя	14
Гарантийный талон	16

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-«КРОНТ» в исполнениях ОБН-150-1-(2х30)-«КРОНТ» и ОБН-150-1-(2х55)-«КРОНТ» (далее по тексту «облучатель») для обеззараживания воздуха разработан в соответствии с Руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (регистрационное удостоверение №РЗН 2015/3099 от 22.09.2015 г.).

Принцип работы облучателя основан на применении УФ-излучения, источником которого являются ультрафиолетовые бактерицидные лампы. Лампы генерируют излучение с длиной волны 253,7 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное воздействие.

1.2. Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха помещений лечебных организаций I-III категории ультрафиолетовым бактерицидным излучением в **отсутствии людей** на этапе подготовки помещения к работе в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий для снижения микробной обсемененности воздуха в соответствии с Руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (табл.1) и в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Помещения, подлежащие оборудованию бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха, в зависимости от категории и необходимого уровня бактерицидной эффективности для *Staphylococcus aureus* (золотистый стафилококк).

Таблица 1

Категория	Типы помещений	Бактерицидная эффективность, % не менее
I	Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей.	99,9
II	Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови.	99,0
III	Палаты, кабинеты и др.помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории).	95,0
IV	Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании.	90,0
V	Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ.	85,0

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

## 2.1. Основные параметры облучателей:

Исполнение	ОБН-150-1-(2x30)	ОБН-150-1-(2x55)
Производительность* при эффективности 99,9%, не менее м <sup>3</sup> /ч	100	200
Производительность* при эффективности 99,0%, не менее м <sup>3</sup> /ч	150	300
Производительность* при эффективности 95,0%, не менее м <sup>3</sup> /ч	230	465
Потребляемая мощность, Вт	150	300
Габаритные размеры, мм	1090x150x100	
Масса не более, кг	3,5	

\* производительность – объем помещения, обеззараживаемый за 1 час

2.2. Материал основания облучателя – листовая сталь (с порошковым покрытием, с порошковым покрытием с антимикробными добавками, нержавеющая полированная или оцинкованная - см. раздел «Свидетельство о приемке»).

2.3. Торцевые блоки выполнены из ударопрочного химически стойкого пластика (полипропилена).

2.4. Питание облучателя от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В при отклонении напряжения сети на ±10% от номинального значения.

2.5. По электробезопасности облучатель соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса I без рабочей части. В этом изделии защита от поражения электрическим током обеспечивается не только ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, но и соединением изделия с защитным заземляющим проводом стационарной проводки посредством трехжильного кабеля.

2.6. Источник излучения – 2 бактерицидные ультрафиолетовые лампы (далее по тексту «лампа»).

Для изготовления бактерицидных ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение с длиной волны ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Поэтому в процессе работы ламп регистрируется предельно малое, в пределах ПДК, образование озона, которое практически исчезает после 100 часов работы лампы.

Исполнение	Источник излучения - у/ф бактерицидная лампа с электрической мощностью, Вт
ОБН-150-1-(2x30)	30
ОБН-150-1-(2x55)	55 (60)

## 2.7. Характеристики источников излучения:

## 2.7.1. Лампа с электрической мощностью 30 Вт:

Тип* лампы	HNS 30W	G30T8	TUV 30W	ДБ 30М	F30T8
Производитель	Osram	LightTech	PHILIPS	НИИИС им. А.Н.Лодыгина	Китай
Электрическая мощность, Вт	30				
Бактерицидный поток, не менее Вт	11		10		9
Средний срок службы лампы, час	9000				8000
Бактерицидная облученность на расстоянии 1 м, не менее Вт/м <sup>2</sup> .	1				
Тип цоколя	G13				
Диаметр колбы, мм	25,5±0,5				

## 2.7.2. Лампа с электрической мощностью 55 (60) Вт:

Тип* лампы	HNS 55W	G55T8	TUV 55W	ДБ 60М
Производитель	Osram	LightTech	PHILIPS	НИИИС им. А.Н.Лодыгина
Электрическая мощность, Вт	55			60
Бактерицидный поток, не менее Вт	18			
Средний срок службы лампы, час	9000			
Бактерицидная облученность на расстоянии 1 м, не менее Вт/м <sup>2</sup> .	1,8			
Тип цоколя	G13			
Диаметр колбы, мм	25,5±0,5			

\* Тип установленной лампы указан в разделе «Свидетельство о приемке».

## 2.8. Облучатель предназначен для работы в условиях:

- Температура окружающего воздуха: +10÷+35°С
- Относительная влажность до 80% при t = 25 °С

- Давление 630±800 мм рт.ст.
- 2.9. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.  
2.10. Срок службы облучателя не менее 5 лет.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Изготовитель оставляет за собой право на замену комплектующих элементов аналогами, установка которых не изменяет технических характеристик изделия.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2x30)-«КРОНТ»:

- |   |       |
|---|-------|
| • Корпус облучателя   | 1 шт. |
| • Лампа* 30 Вт  | 2 шт. |
| • Руководство по эксплуатации                                       | 1 шт. |
| • Вспомогательные принадлежности для установки облучателя на стене: |       |
| - дюбель  | 2 шт. |
| - шуруп   | 2 шт. |

3.2. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-1-(2x55)-«КРОНТ»:

- |   |       |
|---|-------|
| • Корпус облучателя   | 1 шт. |
| • Лампа* 55 (60) Вт   | 2 шт. |
| • Руководство по эксплуатации                                       | 1 шт. |
| • Вспомогательные принадлежности для установки облучателя на стене: |       |
| - дюбель  | 2 шт. |
| - шуруп   | 2 шт. |

\* - облучатель по заказу может поставляться без ламп.

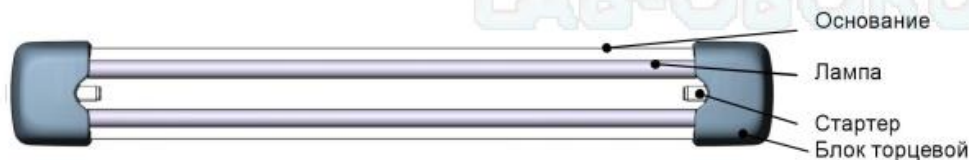


Рис.1

### 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К эксплуатации облучателя допускается медицинский персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации.



**Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать облучатель в присутствии людей.**

4.2. Все работы, связанные с проверкой работоспособности ламп или требующие включения облучателя, должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты органов зрения и кожи (халат, очки и т.п.).



#### **ОСТОРОЖНО!**

Все работы по обслуживанию и ремонту проводить только при отключенном от сети облучателе.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Обеззараживаемое помещение необходимо обеспечить информационным табло с надписью: «НЕ ВХОДИТЬ! ОПАСНО! ИДЕТ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ».

4.3. В случае нарушения целостности колб ламп в облучателе и попадании ртути в помещение должна быть проведена тщательная демеркуризация помещения с привлечением специализированной организации в соответствии с МУ №4545-87 «Методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризацией и оценка ее эффективности».

4.4. Бактерицидные лампы, выработавшие ресурс или вышедшие из строя, до утилизации должны храниться запечатанными в отдельном помещении.

4.5. Приборы и оборудование, для которых воздействие ультрафиолетового излучения опасно, должны быть защищены.

### 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Облучатель состоит из корпуса и установленных в нем 2-х ламп. Корпус состоит из 2-х торцевых блоков, соединенных основанием. Торцевые блоки предназначены для размещения и защиты от внешних воздействий электрических компонентов облучателя и перекрывают доступ к токоведущим частям при случайном прикосновении.

5.2. В каждом торцевом блоке установлены: электромагнитный пускорегулирующий аппарат (далее по тексту «ПРА»), 2 патрона электрических для установки и подключения ламп, стартер рис.1. В правом блоке установлена клеммная колодка для подключения жил кабеля питания, в том числе заземляющего провода стационарной проводки.

5.3. Подключение к стационарной сети напряжением 220 В осуществляется трехжильным кабелем питания стационарной проводки через трехклеммную винтовую колодку (фаза / земля / нейтраль), расположенную на задней стенке правого торцевого блока (рис.2). Сечение жил кабеля не более 6 мм<sup>2</sup>.

5.4. Выключатель сетевой для облучателя следует размещать вне

обрабатываемого помещения возле входной двери. Выключатель не входит в штатную комплектацию облучателя.

## 6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1. После хранения облучателя в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, его можно включить не ранее, чем через 6 часов пребывания при комнатной температуре.
- 6.2. Распаковать облучатель, извлечь лампы из транспортной тары.
- 6.3. Установить поочередно лампы: вставить одновременно цоколи лампы в патроны электрические, расположенные в торцевых блоках облучателя, и повернуть лампу вокруг продольной оси на 90°.
- 6.4. Облучатель устанавливают на стене на высоте не менее 2,0 м от уровня пола. Для установки использовать дюбели и шурупы, входящие в комплект поставки. Расстояние между точками установки дюбелей составляет - 690±1 мм.



**ВНИМАНИЕ!** Облучатель на стене располагают ТОЛЬКО в горизонтальном положении.

- 6.5. Подключить жилы кабеля питания стационарной проводки 220 В (фаза / земля / нейтраль) к трехклеммной колодке, расположенной на задней стенке правого торцевого блока, в соответствии со схемой подключения рис.2.

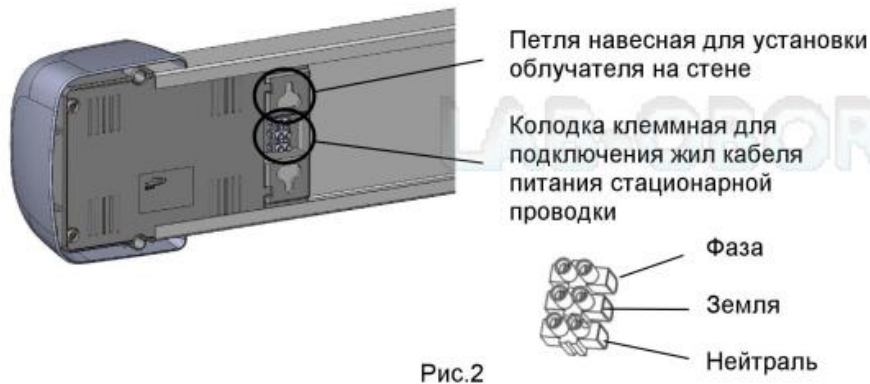


Рис.2

- 6.6. Установить облучатель в выбранном месте на стене. Совместить петли навесные облучателя (рис.2) с установленными дюбелями и шурупами.



### **ВНИМАНИЕ!**

Убедитесь в отсутствии людей в помещении, где необходимо произвести обработку ультрафиолетовым излучением.

- 6.7. Покинуть помещение и, закрыв за собой дверь, включить облучатель - положение выключателя сетевого ВКЛ.
- 6.8. Над входом в помещение, где производится обработка (дезинфекция), должно быть включено световое табло, предупреждающее об опасности, или вывешена на входной двери предупреждающая табличка «НЕ ВХОДИТЬ! ОПАСНО! Идет обеззараживание ультрафиолетовым излучением».
- 6.9. По истечении времени облучения необходимо отключить облучатель - положение выключателя сетевого ОТКЛ, и световое табло или снять табличку.
- 6.10. По окончании работы облучателя можно сразу входить в обработанное помещение - образования озона в воздухе помещения не происходит за счет использования ламп с колбами из специального стекла п.2.6.
- 6.11. В соответствии с Руководством Р.3.5.1904-04 п.п. 8.1. необходимо учитывать время наработки бактерицидных ламп.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

*Названия элементов облучателя, приведенные в данном разделе, соответствуют блок-схеме (рис.5 Приложение 1).*

- 7.1. Техническое обслуживание медицинских изделий должны проводить организации или штатные технические специалисты, имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность, и в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» № 293-22/233 от 27.10.2003г МЗ РФ.
- 7.2. **Внимание!** Все действия, выполняемые в рамках технического обслуживания должны выполняться при отключенном от сети облучателе.
- 7.3. При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 4.
- 7.4. Для обеспечения эффективной эксплуатации облучатель необходимо содержать в чистоте. Периодически (в зависимости от требований, предъявляемых к дезинфекции наружных поверхностей (кроме ламп)) проводить дезинфекцию наружных поверхностей в соответствии с МУ 287-113 способом протирания растворами дезинфицирующих средств при помощи салфетки. Салфетка должна быть хорошо отжата. В качестве дезинфицирующих средств необходимо использовать разрешенные в РФ средства для дезинфекции поверхностей приборов и аппаратов в соответствии с действующими инструкциями по применению конкретных средств. Очистку колб ламп от пыли проводят согласно графику профилактических работ по ультрафиолетовым облучателям, утвержденным в организации. Колбы ламп протирают безворсовой тканью. Дезинфекцию (обработку) проводит медицинский персонал.
- 7.5. По окончании срока службы ламп (8000 или 9000 часов в зависимости от типа установленных ламп) необходимо произвести замену обеих

ламп п.7.6 и провести техническое обслуживание облучателя (очистка узлов от пыли, контроль электрических контактов, крепежных элементов и крепления наконечника провода заземления на корпусе облучателя при помощи винта рис.4).

**Примечание!** Техническое обслуживание облучателя проводится только техническими специалистами с соблюдением правил техники безопасности и с использованием средств защиты.

#### 7.6. Для замены ламп выполнить следующие действия:

- Проверить положение выключателя сетевого. Выключатель должен быть отключен – положение ОТКЛ.
- Снять облучатель со стены, предварительно отсоединив жилы кабеля питания стационарной проводки от клеммной колодки, расположенной на задней стороне правого торцевого блока (рис.2).
- Разместить облучатель на столе.
- Извлечь лампы поочередно: повернуть лампу вокруг продольной оси на 90°, вынуть лампу из патронов.
- Провести дезинфекцию наружных поверхностей облучателя (см.п.7.4).
- Установить поочередно новые лампы: вставить одновременно цоколи лампы в патроны, расположенные в торцевых блоках облучателя, и повернуть лампу вокруг продольной оси на 90°.
- Установить облучатель на место, предварительно подсоединив жилы кабеля питания стационарной проводки к клеммной колодке (рис.2), расположенной на задней стенке правого торцевого блока в соответствии со схемой подключения.
- Демонтированные лампы отправить на утилизацию п.4.4 и п.9.1.

### 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ

8.1. Ремонт медицинских изделий должны проводить организации или штатные технические специалисты, имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность, и в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» № 293-22/233 от 27.10.2003г МЗ РФ.

Таблица 2

Наименование неисправности, внешние признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Облучатель не работает – не горят обе лампы.	1. Нет напряжения в линии питания 220 В. 2. Жилы кабеля питания стационарной проводки не закреплены в клеммной колодке.	1. Проверить напряжение в линии питания. 2. Проверить фиксацию жил в клеммной колодке и при необходимости закрепить (п.6.5)

2. Не горит одна из 2-х ламп.	1. Нет контакта стартера со стартеродержателем. 2. Вышел из строя стартер. 3. Вышел из строя ПРА. 4. Нарушен контакт электродов лампы в патронах электрических. 5. Вышла из строя лампа.	1. Установить стартер заново (рис.1). 2. Заменить стартер (п.8.3.) 3. Заменить ПРА (п.8.2). 4. Установить лампу заново (п.6.3). 5. Заменить лампу (п.7.6).
-------------------------------	--	--

\* Приобрести по заявке любые комплектующие можно на предприятии-изготовителе.


#### 8.2. Замена ПРА:



##### ВНИМАНИЕ!

Не горит верхняя лампа – заменить ПРА, установленный в левом торцевом блоке.  
Не горит нижняя лампа – заменить ПРА, установленный в правом торцевом блоке.

- Проверить положение выключателя сетевого. Выключатель должен быть отключен – положение ОТКЛ.
- Снять облучатель со стены, предварительно отсоединив жилы кабеля питания стационарной проводки от клеммной колодки, расположенной на задней стенке правого торцевого блока (рис.2).
- Снять экран защитный торцевого блока, в котором находится вышедший из строя ПРА, предварительно открутив саморезы крепления экрана (рис.3).

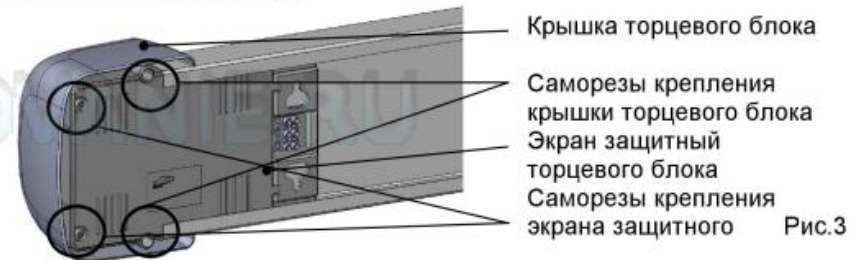

- Отсоединить от колодок клеммных ПРА провода.
- Снять ПРА, предварительно открутив гайки (рис.4).



Рис.4

- Установить новый ПРА, закрепив винтами и гайками.
- Подсоединить провода к колодке клеммной ПРА.
- Установить экран защитный, закрепив саморезами (рис.3).
- Установить облучатель на место, предварительно подсоединив жилы кабеля питания стационарной проводки к клеммной колодке (рис.2), расположенной на задней стенке правого торцевого блока, в соответствии со схемой подключения.
- Демонтированный ПРА отправить на утилизацию п.9.2.

### 8.3. Замена стартера:

- Проверить положение выключателя сетевого. Выключатель должен быть отключен – положение ОТКЛ.
- Извлечь верхнюю лампу: повернуть лампу вокруг продольной оси на 90°, вынуть лампу из патронов.
- Извлечь вышедший из строя стартер из стартеродержателя (рис.1).
- Установить новый стартер.
- Установить лампу на место: вставить одновременно цоколи лампы в патроны, расположенные в торцевых блоках облучателя, и повернуть лампу вокруг продольной оси на 90°.
- Демонтированный стартер отправить на утилизацию п.9.2.

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ

- 9.1. Утилизация ламп ультрафиолетовых бактерицидных, вышедших из строя или с истекшим сроком службы, должна проводиться в соответствии с требованиями «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», утвержденных приказом №120 Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 г.
- 9.2. Утилизация облучателя и его составных частей после истечения срока службы или вышедших из строя должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

## 10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 10.1. Облучатель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих условиях:
- Температура окружающей среды +5 °С ÷ +40 °С.
  - Относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +25 °С. При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной.
  - В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, вызывающих коррозию металла.

- 10.2. Облучатель должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой («Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Крюками не брать», Ограничение по температуре»). Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 90% при температуре +25 °С.

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-«КРОНТ» заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 9451-051-11769436-2015 и признан годным к эксплуатации.

Исполнение облучателя:

- ОБН-150-1-(2x30)-«КРОНТ»
- ОБН-150-1-(2x55)-«КРОНТ»

Тип у/ф лампы:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> HNS 30W | <input type="checkbox"/> HNS 55W |
| <input type="checkbox"/> G30 T8  | <input type="checkbox"/> G55 T8  |
| <input type="checkbox"/> TUV 30W | <input type="checkbox"/> TUV 55W |
| <input type="checkbox"/> ДБ 30М  | <input type="checkbox"/> ДБ 60М  |
| <input type="checkbox"/> F30 T8  |                                  |

Материал основания корпуса облучателя:

- сталь с порошковым покрытием
- сталь с порошковым покрытием с антимикробными добавками
- сталь нержавеющая полированная
- сталь оцинкованная

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Подпись (штамп ОТК) \_\_\_\_\_

Штамп предприятия-изготовителя

## 12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-«КРОНТ» требованиям технических условий ТУ 9451-051-11769436-2015.
- 12.2. Гарантийный срок - 2 года со дня изготовления облучателя.
- 12.3. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель осуществляет ремонт изделия бесплатно.
- 12.4. По желанию потребителя изготовитель за свой счет в течение гарантийного срока может направить комплектующие изделия или его составные части, требующие замены, при условии, что замена может быть произведена квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

**Предприятие-изготовитель оплачивает услуги транспортной компании по доставке и отправке оборудования при гарантийном ремонте от терминала в городе потребителя до терминала в городе Москва.**

Для ускорения процесса доставки предпочтительно пользоваться услугами следующих транспортных компаний: Автотрейдинг, Деловые линии, Желдорэкспедиция.

- 12.5. В случае если проведение ремонта на месте невозможно, потребитель в течение гарантийного срока направляет неисправное изделие на предприятие–изготовитель за счет изготовителя.
- 12.6. Предприятие-изготовитель принимает на гарантийный ремонт только изделия, имеющие гарантийный талон. Гарантийный талон должен быть полностью заполнен.
- 12.7. Срок устранения неисправности не более 30 дней после получения изделия предприятием-изготовителем.
- 12.8. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные нарушением правил эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы, в том числе:
- механическим повреждением изделия в результате удара либо применения чрезвычайной силы;
  - повреждением изделия в результате воздействия горячих предметов или жидкостей;
  - любым посторонним вмешательством в конструкцию изделия.

**Внимание!** В послегарантийный период предприятие-изготовитель осуществляет на договорной основе ремонт облучателя. Срок ремонта не превышает 30 дней.

Блок-схема облучателя

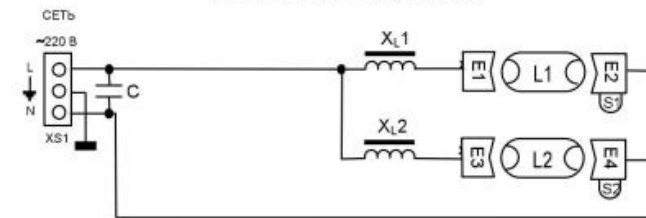


Рис.5

Позиционные обозначения	Наименование
L1, L2	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная 30 Вт или 55 (60) Вт
E1 – E4	Патрон электрический лампы
S1, S2	Стартер S10 (4-65W 220V)
X <sub>L1</sub> , X <sub>L2</sub>	ПРА (Дроссель 30 Вт или 58 Вт)
XS1	Колодка трехклеммная для подключения сети 220 В
C	Конденсатор (0,033 мкФ, 275 В)